


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- ボディ ホワイト（W）、マットブラック（M）、シルバー（S）
- 配光 ナロー（N）、ミディアム（M）
- 首振り角度 上10度 下90度
- 回転角度 380度
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.426A
- 消費電力 42.3W
- 専用ドライバー 消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 器具入力電圧 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電流 37.9V
- 質量 0.9A
- バン、チルトロック 960g（専用ドライバー込み）
- 付属品 工具付属

製品コード

MMP-100S/1H/W·M·S/MS/N·M/30B27/T1/1
MMP-100S/1H/W·M·S/MS/N·M/30B30/T1/1
MMP-100S/1H/W·M·S/MS/N·M/30B35/T1/1
MMP-100S/1H/W·M·S/MS/N·M/30B40/T1/1

オプション

フルディフューザーレンズ	MLA-100/DF01
セミディフューザーレンズ	MLA-100/DS02
フルスプレッドレンズ	MLA-100/SF01
セミスプレッドレンズ	MLA-100/SS01
エッジコントロールレンズ	MLA-100/EC02
シャープナー (N配光専用)	MLA-100/SH01

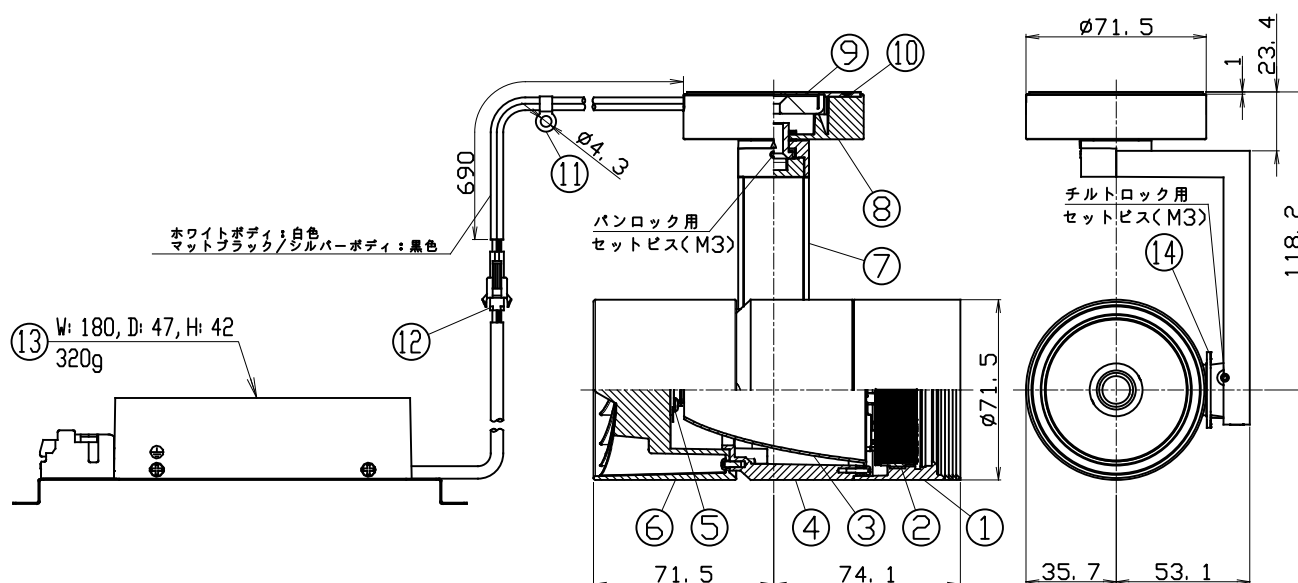


	品 名	材 質	簡 要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	_____
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール	_____	_____
6	ソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	マグネットケース	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	マグネット	_____	_____
10	マグネットカバー	樹脂	滑り止めシート適用
11	セーフティクリップ	真ちゅう	_____
12	セーフティコネクター	樹脂	_____
13	電源ドライバー	_____	逆位相制御方式
14	チルトプロトラクター	樹脂	_____

ご注意

- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、封印に行わないでください。
- 灯具を上向きに照射しないでください。発光部にホコリが積もり、火災の原因になる恐れがあります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 調光器は適合調光器（逆位相制御方式）：SX-CD500 RPC（別売）を使用してください。
- 器具は、照射物より、3m以上離してご使用ください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 不用意に器具に触れるとやけどの恐れがあるため、番付・調整者以外がアームズリーチ内に寄り付けない手段を設ける、もしくは手が触れられぬよう器具に囲いを設けてください。
- パン、チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- パン、チルトロック用のセッティングは読めますまいにください。脱着し、紛失する恐れがあります。

電氣回路

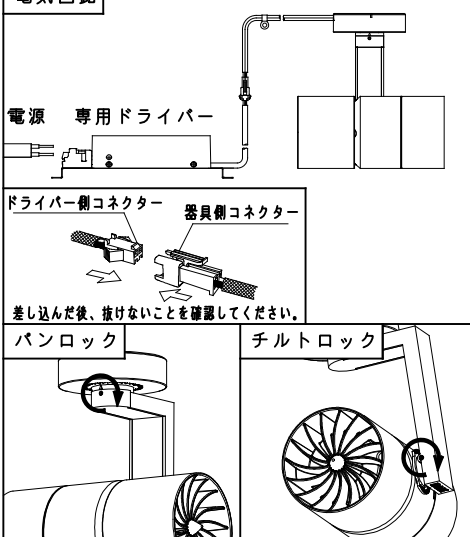

- 落下防止のため、器具側ケーブルに付属されているセーフティクリップをネジ (M4) で器具が 300mm 以内の強固な場所に必ず取付けてください。
- 器具は必ず、凸凹の無い鉄板に取付けてください。
- 器具を取りつけた後は、十分な保持力が確保され、落下しないことを確認してください。
- ペースメーカーなど電子医療器具に器具を近づけないでください。
- 磁気記憶媒体 (フロッピーディスク、磁気カードなど) に器具を近づけないでください。
- 各種電子機器、映像機器、通信機器 (携帯電話、時計など) に器具を近づけないでください。
- 磁石が破損する恐れがありますので、器具に衝撃をあたえないでください。
- 磁石が破損しないよう、高温多湿環境下で作業しないでください。